

Human DPP4 / CD26 Assay Kit - IBL

96 Well

ご使用の際はこの添付文書をよく読んでから使用してください。

全般的な注意

本キットは、研究用試薬です。診断等に用いることはできません。

形状 構造等 (キットの構成)

1 抗体プレート (Anti-hDPP4 (10B1) Mouse IgG.固相)	96Well x 1
2 標識抗体濃縮液 (30倍濃度) (HRP 標識 Anti-hDPP4 (7D1) Mouse IgG Fab' A.P.)	0.4mL x 1
3 標準物質 (Recombinant Human DPP4/CD26)	0.5mL x 2
4 希釈用緩衝液	30mL x 1
5 標識抗体用溶解液	12mL x 1
6 TMB 基質液	15mL x 1
7 停止液	12mL x 1
8 濃縮洗浄液	50mL x 1

測定対象

ヒトの血清、EDTA 血漿、尿、CSF および培養上清

測定原理

本製品は、サンドイッチ法による ELISA (Enzyme-linked Immunosorbent Assay) キットです。1次抗体はプレートに固相されていますので、検体および標準物質を加え1次反応をおこないます。その後、HRP 標識された2次抗体を加え2次反応をおこない、反応後過剰の2次抗体を洗浄除去した後、Tetra Methyl Benzidine (TMB) により発色させます。

操作上の注意

- 検体は、採取後速やかに測定してください。保存する場合は、凍結保存とし、検体の凍結融解を繰り返さないでください。また、融解は低温でおこない測定前に十分混和してください。
- 検体は希釈用緩衝液で希釈してください。
- 検体や標準物質は、二重測定をおすすめします。
- 測定に当たってはその都度検量線を作成してください。
- 検体は、中性域のものを使用してください。また、有機溶媒等の混入も反応に障害がありますので注意してください。
- 試薬は使用前に常温に戻し、数回静かに転倒混和し変化のないことを確かめてください。
- 抗体プレートの洗浄は必ず付属の洗浄液を使用してください。不十分な洗浄は、測定誤差の原因となりますので正確におこなってください。
- 洗浄は機械洗浄 (wait time 0秒) を推奨いたします。洗浄瓶を用いて洗浄する場合は、洗浄液をウェルに満たした後、直ちにプレートを逆さまにして振り払い洗浄液を除去します。この洗浄操作を規定回数おこなってください。操作は洗浄むらのないよう十分注意しておこなってください。*
- 洗浄操作を規定回数おこなった後に、プレートをペーパータオルの上でたたいて、完全に水分を除去してください。この時ペーパータオルがウェルの中に入らないよう注意してください。*10 TMB 基質液は、光に対して敏感です。遮光保存してください。金属との接触も避けてください。使用に際しては必要量を採取用容器にとり分けてください。
- TMB 基質液添加後、反応液は徐々に青色に変わります。この時の反応は、遮光してください。また、採取用容器に残った TMB 基質液は、コンタミの原因となりますので元に戻さないでください。
- 吸光度測定は、停止液添加後 30 分間以内におこなってください。

用法および用量 (操作方法)

- 必要な器具 器材**

プレートリーダー	マイクロピペットおよびチップ
希釈用テストチューブ	メスシリンダーおよびビーカー
精製水	プレートウォッシャー又は洗浄瓶*
ペーパータオル	採取用容器 (清潔な試験管など)
恒温器 (37°C±1°C)	冷蔵庫

2 準備

(1) 濃縮洗浄液の希釈方法

濃縮洗浄液を精製水で 40 倍希釈してください。これを洗浄液とします。必要量を調製してください。

(2) 標識抗体濃縮液の希釈方法

標識抗体濃縮液を別に用意した採取用容器にて、標識抗体用溶解液で 30 倍希釈してください。これを標識抗体とします。

(3) 標準物質の希釈方法

標準物質バイアル瓶に精製水を 0.5 mL 加えて完全に溶解します。

この時標準物質濃度は 16000 pg/mL となります。

希釈用テストチューブを 7 本用意し希釈用緩衝液を 230 μ L ずつ量り取ります。

8000 pg/mL の希釈用テストチューブに 16000 pg/mL の標準物質溶液を 230 μ L 加え混和しその溶液 230 μ L を 4000 pg/mL の希釈用テストチューブに加え混和します。順次 2 倍連続希釈をおこない 8000 pg/mL~125 pg/mL までの 7 点を希釈標準品とします。

Tube-1	8000	pg/mL
Tube-2	4000	pg/mL
Tube-3	2000	pg/mL
Tube-4	1000	pg/mL
Tube-5	500	pg/mL
Tube-6	250	pg/mL
Tube-7	125	pg/mL

(4) 検体の希釈方法

検体は添付の希釈用緩衝液で、下記の希釈倍率にて希釈してください。

ヒトの血清および EDTA 血漿の場合は、100 倍

ヒトの尿の場合は、4 倍

ヒトの CSF の場合は、2 倍

3 測定操作方法 (測定操作一覧 参照)

(1) 検体ブランクの添加

検体ブランクのウェルを設定し、希釈用緩衝液を 100 μ L 入れます。

(2) 検体、希釈標準品の添加

検体 100 μ L および希釈標準品各 100 μ L をそれぞれのウェルに入れます。

(3) プレートカバーをして第 1 反応

(4) 洗浄 (操作上の注意 8.9 参照) *

ウェルの反応液を除去します。洗浄液を加え除去します。

(5) 標識抗体の添加

標識抗体を 100 μ L 添加します。

(6) プレートカバーをして第 2 反応

(7) 洗浄 (操作上の注意 8.9 参照) *

ウェルの反応液を除去します。洗浄液を加え除去します。

(8) TMB 基質液の添加

TMB 基質液を 100 μ L 添加します。

(9) 遮光して発色反応

(10) 停止液の添加

停止液を 100 μ L 添加します。

(11) 吸光度測定

プレート底面のよごれや水滴を拭き取り液面に気泡がないことを確認した後、検体ブランクを対照とした検体および標準の吸光度を測定してください。

測定波長: 450 nm、

2 波長の場合は主波長: 450 nm、副波長: 600~650 nm

測定操作一覧

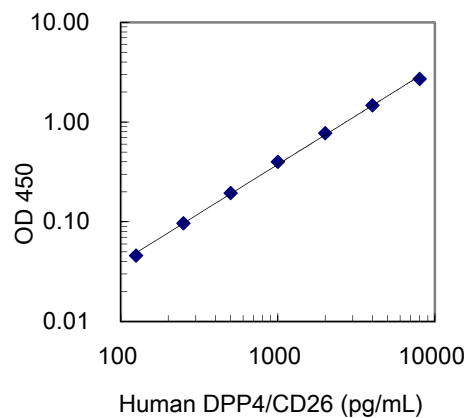
	検体	標準	検体ブランク
試料	検体 100 μ L	希釈標準品 100 μ L	希釈用緩衝液 100 μ L
第 1 反応	プレートカバーをして 37°C 60 分間反応		
洗浄	4 回 (洗浄液 350 μ L 以上) (操作上の注意 8.9 参照) *		
標識抗体	100 μ L	100 μ L	100 μ L
第 2 反応	プレートカバーをして 2~8°C 30 分間反応		
洗浄	5 回 (洗浄液 350 μ L 以上) (操作上の注意 8.9 参照) *		
TMB 基質液	100 μ L	100 μ L	100 μ L
発色反応	遮光常温 30 分間反応		
停止液	100 μ L	100 μ L	100 μ L
吸光度測定	450 nm / 600~650 nm		

測定結果の算出方法

- グラフの X 軸に標準物質濃度を、Y 軸にその吸光度をプロットします。各プロットに適当な回帰曲線を当てはめ(例: 両対数変換の二次回帰等)、検量線を作成します。
- 検体の吸光度を検量線に当てはめ、濃度を読みとります。
- その値に検体の希釈倍率を乗じ、検体の濃度を算出します。

測定値と検量線作成例

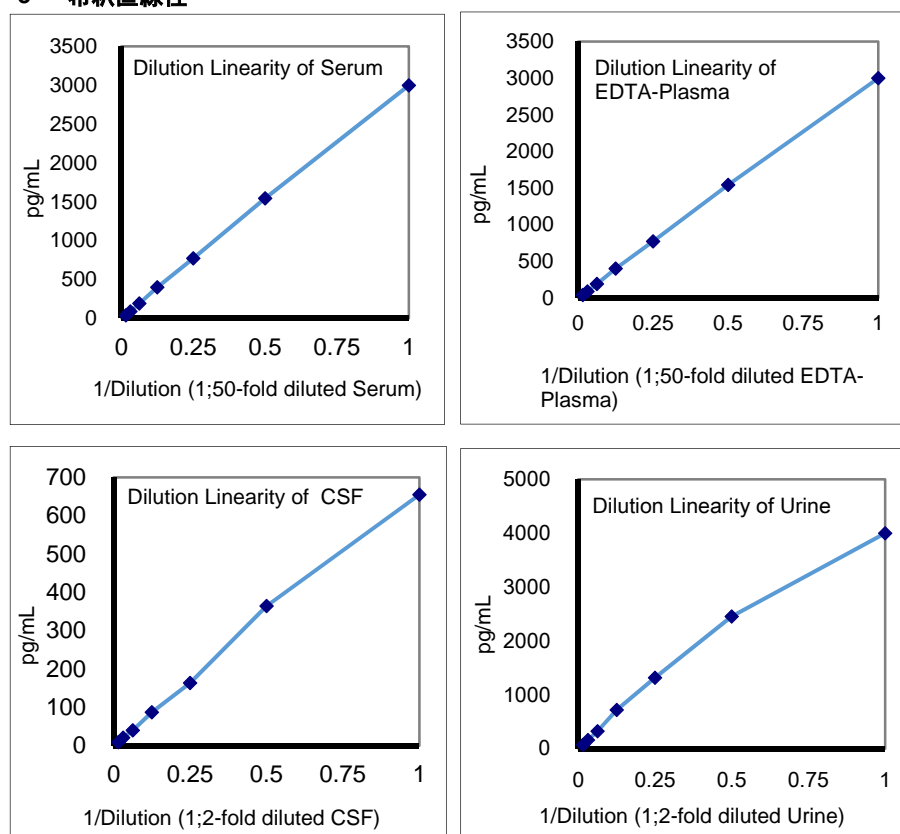
標準品濃度 (pg/mL)	吸光度 (450nm)
8000	2.716
4000	1.472
2000	0.774
1000	0.400
500	0.195
250	0.097
125	0.046


性能
1 感度

8.58 pg/mL (標準品を用いて NCCLS 法にて算出)*

2 測定範囲

125 ~ 8000 pg/mL

3 希釈直線性

4 添加回収試験

検体	添加量 (pg/mL)	理論値 (pg/mL)	測定値 (pg/mL)	%
10%FCS 添加 Supplemented TIL Media x 2	1000	1000	1088	108.8
	500	500	496	99.3
	250	250	247	98.6
Serum x100	1000	2666	2774	104.1
	500	2166	2347	108.3
	250	1916	1969	102.8
EDTA-Plasmamax100	1000	2414	2731	113.1
	500	1914	2184	114.1
	250	1664	1835	110.3
Urine x 4	1000	4178	4618	110.5
	500	3678	4199	114.2
	250	3428	3768	109.9
CSF x 2	1000	1601	1626	101.5
	500	1101	1187	107.8
	250	851	952	111.8

5 同時再現性

測定値 (pg/mL)	SD (pg/mL)	CV (%)	n
4968	222.3	4.5	21
1347	87.1	6.5	21
438	41.4	9.5	21

6 測定間再現性

測定値 (pg/mL)	SD (pg/mL)	CV (%)	n
4873	194.6	4.0	8
1314	40.0	3.0	8
449	36.9	8.2	8

7 特異性

測定物質	交差率%
Human DPP4	100
Mouse DPP4	≤0.1
Rat DPP4	≤0.1

使用上または取り扱い上の注意
1 取り扱い上(危険防止)の注意

- (1) 構成試薬には動物血液成分を含む物があります。取り扱いに注意し使用後は手洗いなどをおこなってください。
- (2) 停止液は強酸性 (1N 硫酸) です。衣服 皮膚等への接触および廃棄には十分注意してください。

2 使用上の注意

- (1) 標準物質は、凍結乾燥品です。開封は、十分注意しゆっくりとおこなってください。
- (2) 保存は、2~8°C としてください。
- (3) 希釈用緩衝液、標識抗体濃縮液および濃縮洗浄液は、まれに析出を認める場合がありますが、性能に問題はありませぬ。
- (4) ロットが異なる製品の構成試薬や他のキットの構成試薬を混ぜたり、交換したりして使用しないでください。
- (5) 期限切れの試薬は、使用しないでください。

3 廃棄上の注意

使用後の抗体プレートや試薬は多量の水で洗い流してから廃棄してください。

貯蔵方法 有効期間

 2~8°C 保存
 使用期限は外箱に記載

包装単位および製品番号

 96 Well
 製品番号 27789

主要文献

- Green BD, Flatt PR, Bailey CJ. Dipeptidyl peptidase IV (DPP IV) inhibitors: A newly emerging drug class for the treatment of type 2 diabetes. *Diab Vasc Dis Res.* 2006 Dec;3(3):159-65.
- Lamers D, Famulla S, Wronkowitz N, Hartwig S, Lehr S, Ouwens DM, Eckardt K, Kaufman JM, Ryden M, Müller S, Hanisch FG, Ruige J, Arner P, Sell H, Eckel J. Dipeptidyl peptidase 4 is a novel adipokine potentially linking obesity to the metabolic syndrome. *Diabetes.* 2011 Jul;60(7):1917-25.
- Havre PA, Abe M, Urasaki Y, Ohnuma K, Morimoto C, Dang NH. The role of CD26/dipeptidyl peptidase IV in cancer. *Front Biosci.* 2008 Jan 1;13:1634-45. Review.

問合せ先

 株式会社 免疫生物研究所
 〒375-0005 群馬県藤岡市中 1091-1
 電話 : 0274-22-2889
 FAX : 0274-23-6055