

**Mouse GIP, Active form (high sensitivity) Assay Kit - IBL**

96 Well

ご使用の際はこの添付文書をよく読んでから使用してください。

**全般的な注意**

本キットは、研究用試薬です。診断等に用いることはできません。

**形状 構造等 (キットの構成)**

|   |            |
|---|------------|
| 1-1 Streptavidin 固相化プレート  | 96Well x 1 |
| 1-2 Biotin 化抗体 (Anti-GIP (C) 27B1 Mouse IgG Biotinylated)           | 12mL x 1   |
| 2 標識抗体濃縮液 (30 倍濃度)<br>(HRP 標識 Anti-GIP (N) 6A1A Mouse IgG Fab' A.P) | 0.4mL x 1  |
| 3 標準物質 GIP (1-42)   | 0.5mL x 2  |
| 4 希釈用緩衝液  | 30mL x 1   |
| 5 抗体用溶解液  | 30mL x 1   |
| 6 TMB 基質液   | 15mL x 1   |
| 7 停止液   | 12mL x 1   |
| 8 濃縮洗浄液   | 50mL x 1   |

**測定対象**

マウス EDTA 血漿

\* 検体採取の際は DPP-IV 阻害剤を添加するか、GIP 専用の採取容器を使用してください。(例: BDTM P800 GLP-1, GIP, Glucagon, Ghrelin 保存用真空採血管, 日本ベクトン デイッキンソン(株))

**測定原理**

本製品は、サンドイッチ法による ELISA (Enzyme-linked Immunosorbent Assay) キットです。Streptavidin が固相されたプレートに Biotin 化抗体を加え補足抗体を固定化します。洗浄後検体および標準物質を加え 1 次反応をおこない、その後、HRP 標識された抗体を加え 2 次反応をおこないます。反応後過剰の 2 次抗体を洗浄除去した後、Tetra Methyl Benzidine (TMB) により発色させます。

**操作上の注意**

- 1 検体は、採取後速やかに測定してください。保存する場合は、凍結保存とし、検体の凍結融解を繰り返さないでください。また、融解は低温でおこない測定前に十分混和してください。
- 2 検体は希釈用緩衝液で希釈してください。
- 3 検体や標準物質は、二重測定をおすすめします。
- 4 測定に当たってはその都度検量線を作成してください。
- 5 検体は、中性域のものを使用してください。また、有機溶媒等の混入も反応に障害がありますので注意してください。
- 6 試薬は使用前に常温に戻し、数回静かに転倒混和し変化のないことを確かめてください
- 7 抗体プレートの洗浄は必ず付属の洗浄液を使用してください。不十分な洗浄は、測定誤差の原因となりますので正確におこなってください。
- 8 洗浄ピンを用いて洗浄する場合は、洗浄液をウェルに満たし、プレートを逆さまにして振り払い洗浄液を完全に除去します。この洗浄操作を規定回数おこなってください。操作は洗浄むらのないよう十分注意しておこなってください。
- 9 洗浄液を捨てた後に、プレートをペーパータオルの上でたたいて、完全に水分を切ってください。この時ペーパータオルがウェルの中に入らないよう注意してください。
- 10 TMB 基質液は、光に対して敏感です。遮光保存してください。金属との接触も避けてください。使用に際しては必要量を採取用容器にとり分けてください。
- 11 TMB 基質液添加後、反応液は徐々に青色に変わります。この時の反応は、遮光してください。また、採取用容器に残った TMB 基質液は、コンタミの原因になりますので元に戻さないでください。
- 12 吸光度測定は、停止液添加後 30 分間以内におこなってください。

**用法および用量 (操作方法)**

**1 必要な器具 器材**

|            |                  |
|------------|------------------|
| プレートリーダー   | マイクロピペットおよびチップ   |
| 希釈用テストチューブ | メスシリンダーおよびピッカー   |
| 精製水        | プレートウォッシャー       |
| ペーパータオル    | 採取用容器 (清潔な試験管など) |
| 冷蔵庫        |                  |

**2 準備**

(1) 濃縮洗浄液の希釈方法

濃縮洗浄液を精製水で 40 倍希釈してください。これを洗浄液とします。必要量を調製してください。

(2) Biotin 化抗体の希釈方法

Biotin 化抗体バイアル瓶に抗体用溶解液を 12 mL 加えて完全に溶解します。これを Biotin 化抗体溶液とします。Biotin 化抗体溶液は凍結保存することができます。凍結融解の繰り返しはできません。

(3) 標識抗体濃縮液の希釈方法

標識抗体濃縮液を別に用意した採取用容器にて、抗体用溶解液で 30 倍希釈してください。これを標識抗体とします。

(4) 標準物質の希釈方法

標準物質バイアル瓶に精製水を 0.5 mL 加えて完全に溶解します。この時標準物質濃度は 64 pmol/L となります。溶解後の標準物質は凍結保存することができます。凍結融解の繰り返しはできません。希釈用テストチューブを 7 本用意し希釈用緩衝液を 230 μL ずつ量り取ります。32 pmol/L の希釈用テストチューブに 64 pmol/L の標準物質溶液を 230 μL 加え混和しその溶液 230 μL を 16 pmol/L の希釈用テストチューブに加え混和します。順次 2 倍連続希釈をおこない 0.5 pmol/L ~ 32 pmol/L までの 7 点を希釈標準品とします。

|        |     |        |
|--------|-----|--------|
| Tube-1 | 32  | pmol/L |
| Tube-2 | 16  | pmol/L |
| Tube-3 | 8   | pmol/L |
| Tube-4 | 4   | pmol/L |
| Tube-5 | 2   | pmol/L |
| Tube-6 | 1   | pmol/L |
| Tube-7 | 0.5 | pmol/L |

(5) 検体の希釈方法

検体は添付の希釈用緩衝液で希釈してください。  
希釈の目安 マウス EDTA 血漿 : 20 倍

**3 測定操作方法 (測定操作一覧 参照)**

- (1) Biotin 化抗体溶液の添加  
必要量のスリットを用意し Biotin 化抗体溶液 100 μL をそれぞれのウェルに入れます。
- (2) プレートカバーをして固定化反応
- (3) 洗浄  
ウェルの反応液を除去します。洗浄液を加え除去します。
- (4) 検体ブランクの添加  
検体ブランクのウェルを設定し、希釈用緩衝液を 100 μL 入れます。
- (5) 検体、希釈標準品の添加  
検体 100 μL および希釈標準品各 100 μL をそれぞれのウェルに入れます。
- (6) プレートカバーをして第 1 反応
- (7) 洗浄  
ウェルの反応液を除去します。洗浄液を加え除去します。
- (8) 標識抗体の添加  
標識抗体を 100 μL 添加します。
- (9) プレートカバーをして第 2 反応
- (10) 洗浄  
ウェルの反応液を除去します。洗浄液を加え除去します。
- (11) TMB 基質液の添加  
TMB 基質液を 100 μL 添加します。
- (12) 遮光して発色反応
- (13) 停止液の添加  
停止液を 100 μL 添加します。
- (14) 吸光度測定  
プレート底面のよごれや水滴を拭き取り液面に気泡がないことを確認した後、検体ブランクを対照とした検体および標準の吸光度を測定してください。  
測定波長 : 450 nm、  
2 波長の場合は主波長 : 450 nm、副波長 : 600~650 nm

測定操作一覧

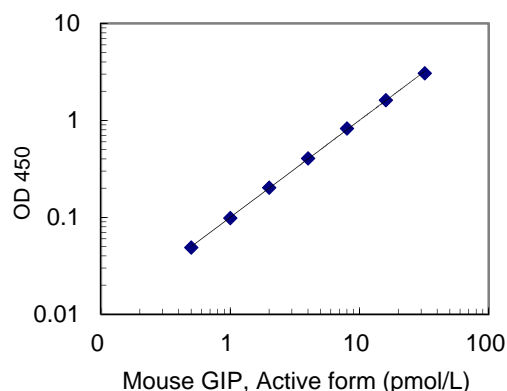
|              |                            |                 |                  |
|--------------|----------------------------|-----------------|------------------|
| Biotin 化抗体溶液 | 100 μL                     |                 |                  |
| 固定化          | プレートカバーをして常温 60 分間反応       |                 |                  |
| 洗 浄          | 2 回 (洗浄液 350 μL 以上)        |                 |                  |
|              | 検 体                        | 標 準             | 検体ブランク           |
| 試 料          | 検体<br>100 μL               | 希釈標準品<br>100 μL | 希釈用緩衝液<br>100 μL |
| 第 1 反応       | プレートカバーをして 2~8°C Overnight |                 |                  |
| 洗 浄          | 4 回 (洗浄液 350 μL 以上)        |                 |                  |
| 標識抗体         | 100 μL                     | 100 μL          | 100 μL           |
| 第 2 反応       | プレートカバーをして 2~8°C 60 分間反応   |                 |                  |
| 洗 浄          | 5 回 (洗浄液 350 μL 以上)        |                 |                  |
| TMB 基質液      | 100 μL                     | 100 μL          | 100 μL           |
| 発色反応         | 遮光常温 30 分間反応               |                 |                  |
| 停 止 液        | 100 μL                     | 100 μL          | 100 μL           |
| 吸光度測定        | 450 nm / 600~650 nm        |                 |                  |

**測定結果の算出方法**

- 1 グラフのX軸に標準物質濃度を、Y軸にその吸光度をプロットします。各プロットに適当な回帰曲線を当てはめ(例: 両対数変換の二次回帰等)、検量線を作成します。
- 2 検体の吸光度を検量線に当てはめ、濃度を読みとります。
- 3 その値に検体の希釈倍率を乗じ、検体の濃度を算出します。

定値と検量線作成例

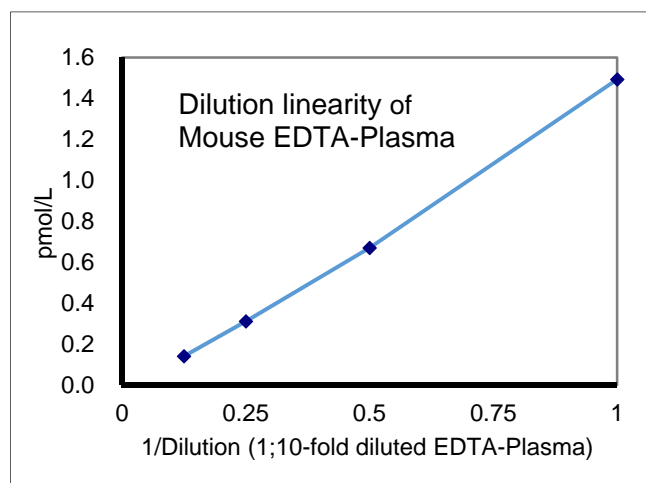
| 標準品濃度 (pmol/L) | 吸光度 (450nm) |
|----------------|-------------|
| 32             | 3.069       |
| 16             | 1.618       |
| 8              | 0.827       |
| 4              | 0.407       |
| 2              | 0.203       |
| 1              | 0.098       |
| 0.5            | 0.049       |


**性能**
**1 感度**

0.25 pmol/L

**2 測定範囲**

0.5 ~ 32 pmol/L

**3 希釈直線性**

**4 添加回収試験**

| 検体                | 添加量 (pmol/L) | 理論値 (pmol/L) | 測定値 (pmol/L) | %    |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|------|
| マウス EDTA 血漿 (X20) | 16.00        | 16.33        | 14.08        | 86.2 |
|                   | 4.00         | 4.33         | 3.97         | 91.7 |
|                   | 1.00         | 1.33         | 1.24         | 93.2 |

**5 同時再現性**

| 測定値 (pmol/L) | SD 値 (pmol/L) | CV 値 (%) | n  |
|--------------|---------------|----------|----|
| 16.50        | 0.70          | 4.2      | 24 |
| 3.15         | 0.14          | 4.4      | 24 |
| 0.78         | 0.05          | 6.4      | 24 |

**6 測定間再現性**

| 測定値 (pmol/L) | SD 値 (pmol/L) | CV 値 (%) | n |
|--------------|---------------|----------|---|
| 15.57        | 0.36          | 2.3      | 6 |
| 3.94         | 0.14          | 3.6      | 6 |
| 1.29         | 0.10          | 7.8      | 6 |

**7 特異性**

| 測定物質             | 交差率(%) |
|------------------|--------|
| Mouse GIP(1-42)  | 100    |
| Mouse GIP(3-42)  | ≤0.1   |
| GLP-1(7-36)amide | ≤0.1   |
| GLP-1(7-37)      | ≤0.1   |
| GLP-1(9-36)amide | ≤0.1   |
| GLP-1(1-37)      | ≤0.1   |
| Glucagon         | ≤0.1   |

**使用上または取り扱い上の注意**
**1 取り扱い上(危険防止)の注意**

- (1) 構成試薬には動物血液成分を含む物があります。取り扱いに注意し使用後は手洗いなどをおこなってください。
- (2) 停止液は強酸性 (1N 硫酸) です。衣服 皮膚等への接触および廃棄には十分注意してください。

**2 使用上の注意**

- (1) 標準物質は、凍結乾燥品です。開封は、十分注意しゆっくりとおこなってください。
- (2) 保存は、2~8°C としてください。
- (3) 希釈用緩衝液、標識抗体濃縮液および濃縮洗浄液は、まれに析出を認める場合がありますが、性能に問題はありません。
- (4) ロットが異なる製品の構成試薬や他のキットの構成試薬を混ぜたり、交換したりして使用しないでください。
- (5) 期限切れの試薬は、使用しないでください。

**3 廃棄上の注意**

使用後の抗体プレートや試薬は多量の水で洗い流してから廃棄してください。

**貯蔵方法 有効期間**

 2~8°C 保存  
 使用期限は外箱に記載

**包装単位および製品番号**

 96 Well  
 製品番号 27702

**問合せ先**

 株式会社 免疫生物研究所  
 〒375-0005 群馬県藤岡市中 1091-1  
 電話 : 0274-22-2889  
 FAX : 0274-23-6055